

Raport miesięczny


PAŹDZIERNIK 2018

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

Sprzedaż w okresie styczeń – październik 2018 r. wyniosła 23 225 tys. zł.

Wyszczególnienie	I-X 2018	I-X 2017	Dynamika 2018/2017
Sprzedaż razem	23 225	23 374	99,36%
Mikrobiologia	9 981	10 402	95,95%
Szybkie testy i paski do moczu	3 610	3 888	92,85%
Analityka (biochemia, hematologia, jony, immunochemia)	3 749	3 356	111,71%
System pobierania krwi i materiały zużywalne	3 604	3 679	97,96%
Aparatura	1 264	1 222	103,44%
Szkolenia, usługi, pozostałe	1 017	827	122,97%


Wyszczególnienie	I-X 2018	I-X 2017	Dynamika 2018/2017
Sprzedaż razem	23 225	23 374	99,36%
Przychody ze sprzedaży wyrobów	12 530	12 813	97,79%
Przychody ze sprzedaży towarów	10 695	10 561	101,27%

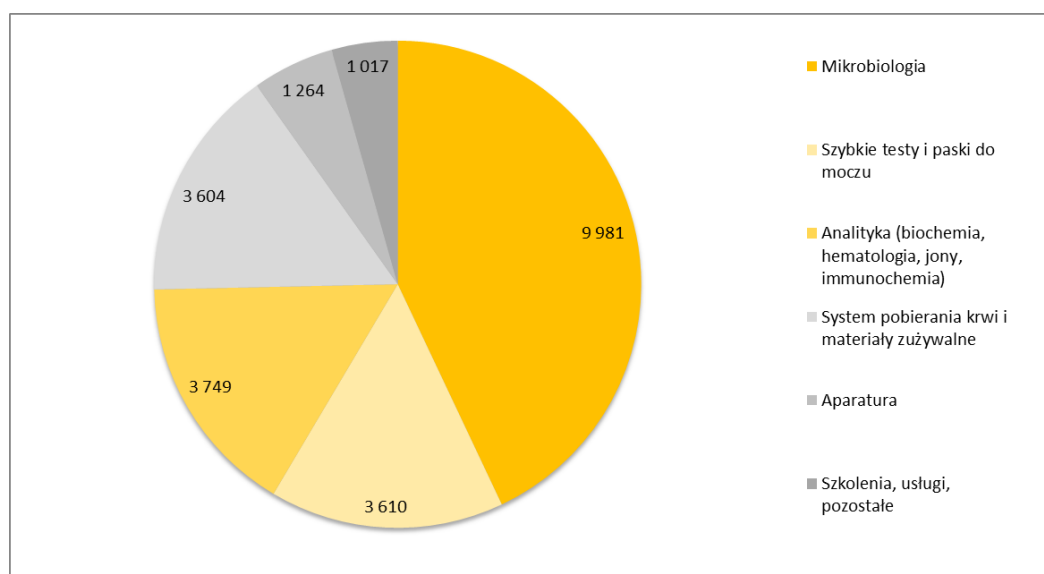

W październiku obserwujemy dalszy stopniowy wzrost przychodów w kategorii mikrobiologia, a także przychodów ze sprzedaży wyrobów w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Jest to efekt odbudowy mocy produkcyjnych które w listopadzie br. Powinny osiągnąć 100% mocy wytwórczych sprzed przeprowadzki we wszystkich wydziałach produkcji mikrobiologicznej.

Sprzedaż eksportowa w miesiącach styczeń - październik 2018 r. wyniosła 5 655 tys. zł. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem wyniósł 24,4%.

Wyszczególnienie	I-X 2018	I-X 2017	Dynamika 2018/2017
Sprzedaż eksport	5 655	6 399	88,37%
Styczeń	726	651	111,52%
Luty	415	681	60,94%
Marzec	724	555	130,45%
Kwiecień	480	516	93,02%
Maj	384	787	48,79%
Czerwiec	875	679	128,87%
Lipiec	376	638	58,93%
Sierpień	484	529	91,49%
Wrzesień	712	811	87,79%
Październik	479	552	86,78%

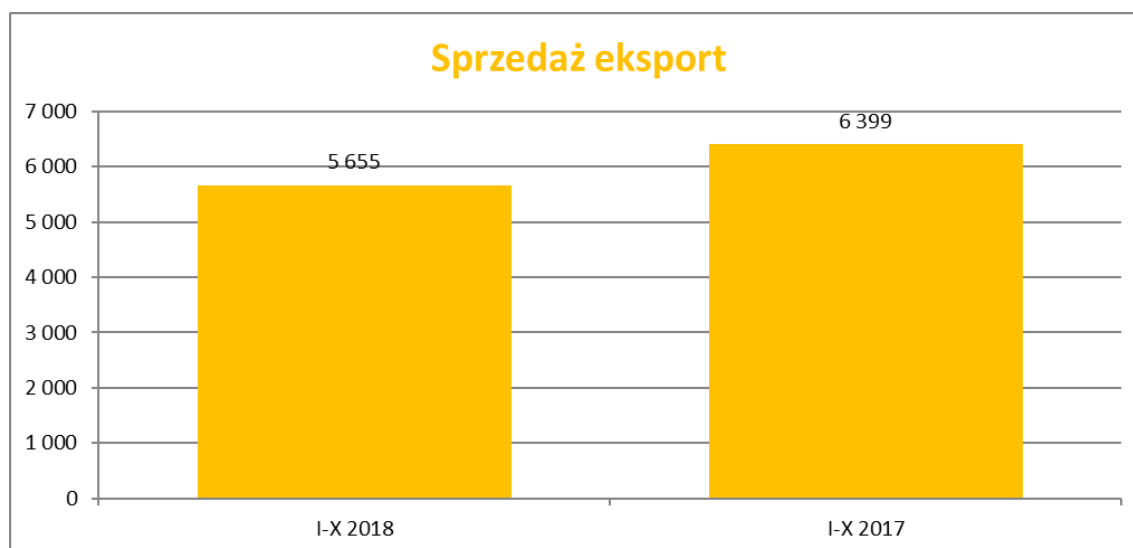

Potwierdzona została testowa instalacja systemu Accelerate Pheno™ w jednym z wiodących ośrodków klinicznych w kraju wraz zakupem pakietu testów. System zostanie zainstalowany w listopadzie b.r., okres testowania jest wstępnie przewidziany na dwa miesiące.

Systemu Accelerate Pheno™, to platforma nowej generacji do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów z dodatnich posiewów krwi i oznaczania ich lekowrażliwości w leczeniu sepsy. System gwarantuje uzyskanie wyniku identyfikacji już w 90 minut a kompletnego wyniku, łącznie z oznaczeniem lekowrażliwości, podawanym jako MIC (minimalne stężenie hamujące), maksymalnie w ciągu 7 godzin. We wrześniu br. zespół zajmujący się wprowadzaniem Accelerate Pheno™ na rynek rozpoczął pracę i odbyło szereg rozmów z liderami opinii oraz nawiązano kontakt z wiodącymi placówkami klinicznymi w kraju. System wzbudził duże zainteresowanie potencjalnych klientów i obecnie rozpocznie się pierwsza testowa instalacja w dużym ośrodku klinicznym.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w miesiącu październiku:

Rb nr 29/2018 – Raport miesięczny BioMaxima S.A. za wrzesień 2018 r.

Raporty bieżące opublikowane w ESPI w miesiącu październiku:

Rb nr 15/2018 – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Rb nr 16/2018 - Informacja o rozpoczęciu testowania system Accelerate Pheno™ u potencjalnego klienta, w jednym z wiodących ośrodków klinicznych w kraju

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W październiku 2018 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do dnia 14 grudnia 2018 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad 2018 r.